


臨床試驗藥局**冰箱溫度異常**處理流程圖

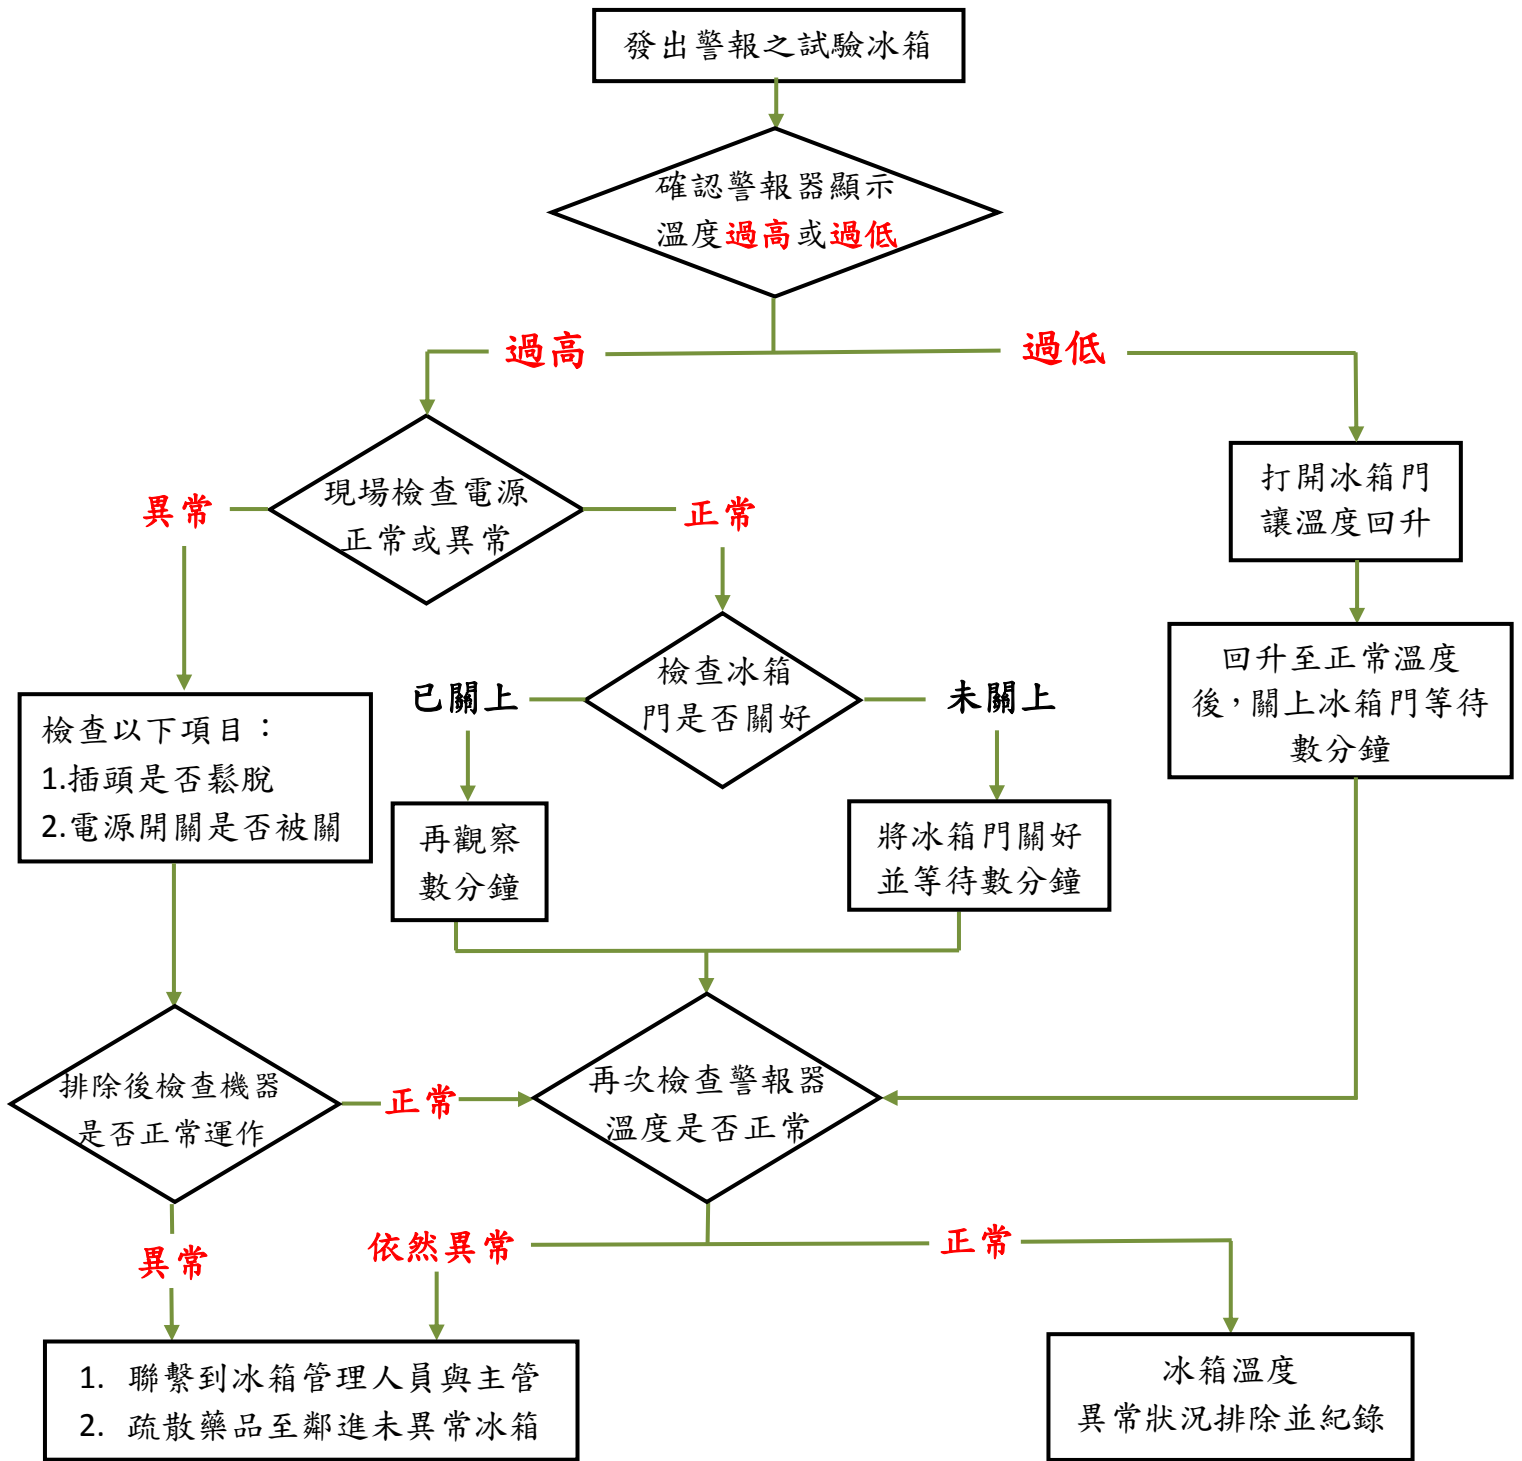

- 臨床試驗藥局溫度異常聯絡人員**
1. 急診藥局 07-3121101 轉 7168
 2. 臨床試驗藥局：第一專責藥師
 3. 藥品調劑組組長 07-3121101 轉 7174
 4. 臨床試驗藥局：第二專責藥師
 5. 臨床試驗藥局：第三專責藥師